

PX-100CL

BATTERY MOBILE X-RAY UNIT
回診用X線撮影装置



Medison Acoma Co., Ltd.


仕様

発生器	インバータ制御システム		
定格	40~100KV 30mA (MAX)		
mAs	0.4~98mAs (25ステップ)		
X線管球	焦点寸法	:1.2mm IEC	
	陽極	:固定	
	陽極熱容量	:20KHU	
	固有ろ過	:0.8mmAl当量min	
バッテリー	タイプ	:HV2.6-12	
	容量	:20個直列	
	電源容量	:DC. 240V	
バッテリー 充電	充電時間	:約8時間	
	電源	:单相100V 50/60Hz	
	電源容量	:200VA	
コリメーター	照射野投光式 30秒タイマー		
リモコン スイッチ	X線曝射可能距離	:約5m	
	リモコン受光範囲	:270°	
重量	130kg		
その他標準仕様	X線管球アーム :スプリングバランス方式 カセット収納枚数 :14"×17"カセット10枚		

システム構成

X線発生装置 (X線管球、高圧発生装置を含む)
X線制御器 (インバーター、バッテリー、バッテリー充電機を含む)
コリメーター
撮影用ハンドスイッチ
リモコン曝射スイッチ
回診用スタンド

寸法図

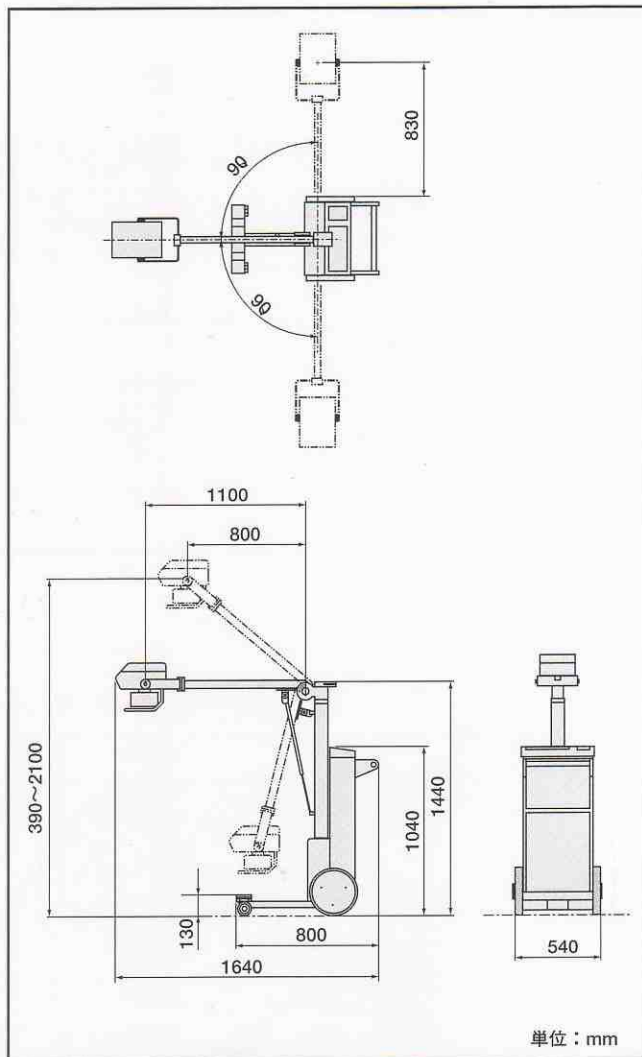

【 承認番号 (06B) 第1106号 】

- 製品写真は印刷物ですので、実物と若干異なる場合があります。
- 仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にてご相談ください。
もし販売店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。

- お問い合わせ・カタログ請求はまずお電話どうぞ……
- お求めはアフターサービスの行き届いた当社へ……



株式会社 **メディソンアコマ**

東京都文京区本郷 3-22-8 〒113-0033

[TEL] 03-3813-4691

[FAX] 03-3813-4696